

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

**Изделия медицинские электрические  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННО-  
ОПТИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ  
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ**

**Ч а с т ь 5**

**Определение квантовой эффективности регистрации**

**Издание официальное**

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН** Всероссийским научно-исследовательским и испытательным институтом медицинской техники (ВНИИИМТ)

**ВНЕСЕН** Техническим комитетом по стандартизации ТК 668 «Аппараты и оборудование для лучевой диагностики, терапии и дозиметрии»

**2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. № 832-ст

**3** Разделы настоящего стандарта представляют собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 61262-5—94 «Изделия медицинские электрические. Характеристики электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения. Часть 5. Определение квантовой эффективности регистрации»

**4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© ИПК Издательство стандартов, 2000

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Определения . . . . .	1
3.1 Используемые термины . . . . .	1
3.2 Степень обязательности требований . . . . .	2
4 Требования . . . . .	2
4.1 Исходные установки . . . . .	2
4.2 Условия работы УСИЛИТЕЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ . . . . .	2
4.3 Входное ИЗЛУЧЕНИЕ . . . . .	2
4.4 ТЕСТ-ОБЪЕКТ . . . . .	3
4.5 Измерительное оборудование . . . . .	3
5 Определение КВАНТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ . . . . .	4
5.1 Подготовка . . . . .	4
5.2 Измерение . . . . .	5
5.3 Коррекция . . . . .	5
5.4 Определение . . . . .	5
6 Представление КВАНТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ . . . . .	6
7 Обозначение соответствия . . . . .	6
Приложение А Указатель терминов . . . . .	7
Приложение Б Типовая схема проведения испытаний . . . . .	8
Приложение В Типовой амплитудный спектр импульсных сцинтилляций . . . . .	9
Приложение Г Библиография . . . . .	10

## Введение

Настоящий стандарт является прямым применением международного стандарта МЭК 61262-5 «Изделия медицинские электрические. Характеристики электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения. Часть 5. Определение квантовой эффективности регистрации», подготовленного Подкомитетом 62B «Аппараты для лучевой диагностики» Технического комитета МЭК 62 «Изделия медицинские электрические».

Определение КВАНТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ( $K_s$ ) — это измерение качества изображения системы, базирующееся на сравнении отношения сигнал/шум на выходе с отношением сигнал/шум на входе. Для линейных систем формирования изображений корректен анализ отношения сигнал/шум и  $K_s$  как функции синусоидально изменяющихся сигналов.

В настоящем стандарте установлены детальные условия для определения  $K_s$  ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ для близких к нулю пространственных и временных частот. Используемый метод основан на анализе спектра сцинтилляций (ССА).

ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ на входе — радионуклид  $^{241}\text{Am}$ , который предпочтительнее ИСТОЧНИКА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, так как радионуклидный источник свободен от дрейфа и периодических флукутаций и испускает гамма-излучение в области энергий рентгеновского диапазона. Сигнал люминофора на выходе ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ интегрируется на плоскости, которая больше изображения источника.

Кроме того, метод ССА требует интегрирования практически всей энергии световых фотонов на выходе ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ, появившихся в результате поглощения одного фотона гамма-излучения. Эти характеристики являются результатом измерений вблизи нулевых как пространственных, так и временных частот.

Настоящий стандарт предполагает измерение  $K_s$  только вблизи ЦЕНТРА ВХОДНОГО ПОЛЯ.

С другой стороны метод ССА не рекомендуется для ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ с временем затухания выходного люминофора существенно большим, чем у люминофора Р-20. Обычно, когда фотон гамма-излучения поглощен, интенсивность светового импульса через 1 мс после начала импульса должна быть меньше 10 % максимальной интенсивности. Это означает, что временной интервал между началом импульса и максимумом интенсивности значительно меньше чем 1 мс. Так как метод ССА требует интегрирования излучения от каждого отдельного фотона гамма-излучения, то применение люминофоров с длительным временем затухания вызывает необходимость использования очень низких скоростей счета фотонов гамма-излучения, которые могут быть сравнимы со скоростью счета шумового фона.

Известно, что существуют другие методы измерений  $K_s$ , например, анализ вспышек импульсов, анализ среднего квадратического значения шума и имитация квантового поглощения в части физических характеристик ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ. Методы, которые обеспечивают корректные результаты измерения  $K_s$  с точностью не хуже, чем при измерениях по методике настоящего стандарта, являются также применимыми.

В настоящем стандарте приняты следующие типы шрифтов:

- методы испытаний — курсив;
- термины, определяемые в пункте 3.1 и в приложении А настоящего стандарта, — прописные буквы.

В Российской Федерации действует ГОСТ 26141—84 «Усилители рентгеновского изображения медицинских аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний». ГОСТ 26141 распространяется на усилители рентгеновского изображения (УРИ), включающие в себя блок преобразования на основе рентгеновского электронно-оптического преобразователя (РЭОП) в защитном кожухе и блок питания электродов РЭОП, а также замкнутую телевизионную систему (ЗТС) с монитором (видеоконтрольным устройством). Параметры качества изображения, нормируемые ГОСТ 26141, включают в себя требования к телевизионной системе и оцениваются наблюдателем либо измеряются, как правило, на экране монитора ЗТС.

В МЭК 60788, а также в настоящем стандарте под термином УСИЛИТЕЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (УРИ) понимается устройство для преобразования РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ в усиленное видимое изображение с использованием дополнительного источника энергии для этого усиления, т.е. УРИ — блок преобразования, включающий в себя РЭОП и его блок питания. Параметры изображения измеряются на выходном экране РЭОП с применением увеличительных оптических устройств.

КВАНТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ( $K_s$ ), методы определения которой изложены в настоящем стандарте, характеризует шумовые свойства РЭОП. Проведение подобных сложных измерений рекомендуется осуществлять в лабораторных условиях предприятия-изготовителя при разработке РЭОП и его периодических испытаниях.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****Изделия медицинские электрические****ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ****Часть 5****Определение квантовой эффективности регистрации**

Medical electrical equipment

Characteristics of electro-optical X-ray image intensifiers Part 5 Determination of the detective quantum efficiency

Дата введения 2001—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ, используемые в медицинской практике в составе диагностических РЕНТГЕНОВСКИХ АППАРАТОВ

Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

Настоящий стандарт устанавливает метод определения КВАНТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ( $K_d$ ) ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ посредством анализа амплитудного спектра импульсов сцинтиляций фотонов, вызванных гамма-излучением.

Этот метод применяют только для ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ, со скоростью затухания свечения на выходе, примерно равной или выше по отношению к люминофору Р-20

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте используют ссылку на стандарт:

МЭК 60788—84 Медицинская радиационная техника. Термины и определения

**3 Определения****3.1 Используемые термины**

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями\*  
3 1 1 УРИ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ;

3.1.2 ВХОДНАЯ ПЛОСКОСТЬ: Плоскость, перпендикулярная к оси симметрии УРИ и касательная к той части его корпуса, которая максимально выступает в сторону ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ;

3.1.3 ВХОДНОЕ ПОЛЕ: Область ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ УРИ, которая может быть использована для передачи РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ при установленных условиях;

3 1 4 Не использован;

3 1 5 РАССТОЯНИЕ ИСТОЧНИК — ВХОДНАЯ ПЛОСКОСТЬ (сокращенно РИВ). Расстояние между фокусным пятном РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ и ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ УРИ;

\* Наряду с нижеприведенными терминами применяют термины по МЭК 60788 (см приложение А). В тех случаях, когда наименование термина, определенного в 3 1 1 — 3 1 14, совпадает с приведенным в МЭК 60788, преимущество имеет определение термина настоящего стандарта

3.1.6 **ЦЕНТР ВЫХОДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:** Центр наименьшей окружности, описывающей ВЫХОДНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ;

3.1.7 **ЦЕНТР ВХОДНОГО ПОЛЯ:** Точка ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ, которая изображается в ЦЕНТРЕ ВЫХОДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ;

3.1.8 **ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОСЬ:** Линия, перпендикулярная к ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ, проходящая через центр ВХОДНОГО ПОЛЯ;

3.1.9 Не использован;

3.1.10 **ЭФФЕКТИВНАЯ АПЕРТУРА:** Зона на ВХОДНОМ ЭКРАНЕ УРИ, которая облучается ИСТОЧНИКОМ ИЗЛУЧЕНИЯ через ВХОДНУЮ АПЕРТУРУ;

П р и м е ч а н и е — Вследствие геометрического увеличения и конечных размеров источника диаметр этой зоны всегда больше, чем диаметр ВХОДНОЙ АПЕРТУРЫ.

3.1.11 **КВАНТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ( $K_r$ ):** Отношение квадрата отношения сигнала/шум на выходе ДЕТЕКТОРА ИЗЛУЧЕНИЯ к квадрату отношения сигнала/шум на входе ДЕТЕКТОРА ИЗЛУЧЕНИЯ;

3.1.12 **КВАНТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ ( $A_0$ ):** Число фотонов, падающих на вход ДЕТЕКТОРА ИЗЛУЧЕНИЯ и вызывающих сигнал на выходе ДЕТЕКТОРА ИЗЛУЧЕНИЯ, деленное на полное число падающих фотонов;

3.1.13 **ВХОДНАЯ АПЕРТУРА:** Апертура, которая определяет площадь поперечного сечения ПУЧКА ИЗЛУЧЕНИЯ;

3.1.14 **ИМПУЛЬС ЕДИНИЧНОГО ФОТОНА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ:** Число световых фотонов, эмитируемых ВЫХОДНЫМ ЭКРАНОМ УРИ, в результате взаимодействия одного ФОТОНА гамма-излучения установленной энергии с ВХОДНЫМ ЭКРАНОМ УРИ;

### 3.2 Степень обязательности требований

В настоящем стандарте использованы следующие вспомогательные термины:

- **должен:** Соответствие требованиям обязательно для соответствия настоящему стандарту;

- **рекомендуется:** Соответствие требованиям рекомендовано, но необязательно для соответствия настоящему стандарту;

- **может:** Описания допустимых путей достижения соответствия настоящим требованиям;

- **установленный:** Обозначения определенных данных, приведенных в настоящем стандарте или в стандартах, на которые даны ссылки, и обычно относящихся к конкретным условиям работы и испытаний или к значениям, по которым определяют соответствие (см. МЭК 60788, определение МР-74-01);

- **нормируемый:** Обозначения определенных данных, указываемых обычно ИЗГОТОВИТЕЛЕМ в СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ на аппарат, касающихся, главным образом, его назначения, параметров, условий эксплуатации или испытаний на соответствие (см. МЭК 60788, определение МР-74-02);

- **предназначенный:** Используется для характеристики оборудования, устройств или их составляющих: определяет их назначение или цель применения изделия.

## 4 Требования

В настоящем разделе приведены характеристики аппаратуры и условия, необходимые для определения КВАНТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ.

Типовая схема проведения испытаний приведена в приложении Б.

### 4.1 Исходные установки

Не используется.

### 4.2 Условия работы УСИЛИТЕЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

а) УРИ должен работать в условиях НОРМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, нормированных изготовителем;

б) Не следует применять ОТСЕИВАЮЩИЙ РАСТР и защитные покрытия;

в) В случае многопольного УРИ измерения должны проводить для наибольшего нормированного ВХОДНОГО ПОЛЯ.

### 4.3 Входное Излучение

а) Источником входного ИЗЛУЧЕНИЯ должен быть радионуклид  $^{241}\text{Am}$ , который имитирует фотоны гамма-излучения энергией 59,5 кэВ;

б) Выход источника может включать частицы иные, чем те, которые излучаются при распаде

<sup>241</sup>Ам, например, рентгеновское излучение слоя *L* нептуния и рентгеновские лучи люминесценции от материалов, используемых в конструкции источника и его контейнера:

1) Интенсивность квантов энергией, отличающейся от 59,5 кэВ, должна быть меньше 1 % интенсивности квантов энергией 59,5 кэВ.

Требуемый уровень спектральной чистоты может быть достигнут использованием ФИЛЬТРА из 0,5 мм меди. Этот ФИЛЬТР уменьшает поток фотонов энергией 59,5 кэВ с коэффициентом, равным приблизительно 2.

2) Любой ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР должен быть расположен насколько возможно близко к источнику и более близко к источнику, чем ВХОДНАЯ ПЛОСКОСТЬ УРИ или контрольный детектор (см. 4.5.2).

в) АКТИВНОСТЬ источника должна обеспечивать скорость счета  $R_u$  от 50 до 500 фотонов энергии 59,5 кэВ в секунду на ВХОДНОЙ АПЕРТУРЕ при геометрических условиях 4.4.2. Для этого необходима активность около  $10^7$  Бк.

#### 4.4 ТЕСТ-ОБЪЕКТ

##### 4.4.1 ВХОДНАЯ АПЕРТУРА

а) Поперечное сечение ПУЧКА ИЗЛУЧЕНИЯ, падающего как на УРИ, так и на детектор (см. 4.5.2), должно быть ограничено именно этой ВХОДНОЙ АПЕРТУРОЙ;

б) Для того, чтобы избежать отклонений от планируемого результата на выходе вследствие локальных изменений толщины ВХОДНОГО ЭКРАНА, диаметр ВХОДНОЙ АПЕРТУРЫ должен быть не менее 4 мм;

в) Для контрольного детектора, содержащего кристалл, ВХОДНАЯ АПЕРТУРА должна ограничивать пучок на площади, не превышающей площадь базы кристалла; падающий пучок не должен пронизывать стенки кристалла;

г) Толщина сечения ВХОДНОЙ АПЕРТУРЫ по эквиваленту поглощения должна быть не менее 3 мм свинца.

##### 4.4.2 Геометрия измерений

а) Для ограничения отклонений поглощения гамма-лучей во ВХОДНОМ ЭКРАНЕ УРИ и увеличения ЭФФЕКТИВНОЙ АПЕРТУРЫ вследствие расширения падающего пучка угол  $\theta$  должен быть не более  $2^\circ$  (см. рисунок 1) и определяется по формуле

$$\theta = \arctg [(d_0 + d_1)/2L],$$

где  $d_0$  — диаметр источника;

$d_1$  — диаметр ВХОДНОЙ АПЕРТУРЫ;

$L$  — расстояние между ИСТОЧНИКОМ ИЗЛУЧЕНИЯ и ВХОДНОЙ АПЕРТУРОЙ.

б) Одно и то же значение  $d_0$ ,  $d_1$  и  $L$  должно быть использовано для измерений с контрольным детектором и УРИ.

#### 4.5 Измерительное оборудование

##### 4.5.1 Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ)

Фотоэлектронный умножитель должен использоваться для детектирования света, эмитируемого УРИ, и света, эмитируемого сцинтилляционным кристаллом, если используется контрольный детектор с сцинтилляционным кристаллом.

##### 4.5.1.1 Условия работы ФЭУ

а) Высоковольтный источник, питающий ФЭУ, должен обеспечивать линейный отклик ФЭУ;

б) Высокое напряжение должно быть приложено к ФЭУ за время не более 30 мин до начала измерений, чтобы обеспечить стабильность отклика ФЭУ.

##### 4.5.1.2 Установка ФЭУ

а) ФЭУ и УРИ должны быть защищены, чтобы избежать детектирования паразитного света;

б) Для измерений спектра амплитуды импульсов сцинтилляций рекомендуется, чтобы эффективность оптической схемы между ФЭУ и ВЫХОДНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ УРИ была не менее 5 % световых фотонов, эмитируемых под воздействием ИМПУЛЬСА ЕДИНИЧНОГО ФОТОНА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ, поступающих на фотокатод ФЭУ.

Это может быть достигнуто расположением ФЭУ непосредственно напротив выходного окна УРИ или использованием оптики с широкой апертурой ( $\geq F/2$ ).

в) В случае, когда используется оптика, ВЫХОДНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ УРИ должно быть сфокусировано на входе ФЭУ, чтобы предотвратить расширение спектра вследствие неоднородности фотокатода ФЭУ;

г) Фоновый свет, имитируемый выходным люминофором вне площади изображения ВХОДНОЙ АПЕРТУРЫ, может вызвать необходимость защиты ФЭУ соответствующей маской.

При использовании маски ее апертура не должна препятствовать прохождению фотонов, имитируемых зоной ВЫХОДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ, диаметр которой должен быть не менее двойного диаметра ЭФФЕКТИВНОЙ АПЕРТУРЫ.

#### 4.5.2 Контрольный детектор

Контрольный детектор используется для измерений потока фотонов энергией 59,5 кэВ, падающих на ВХОДНУЮ ПЛОСКОСТЬ. КВАНТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИСТРАЦИЙ контрольного детектора на этой энергии должна быть достаточно высокой или должна быть известна с достаточной точностью, т. е. погрешность измерений должна быть не более  $\pm 2\%$  абсолютного значения.

#### 4.5.3 Импульсный процессор

а) Импульсный процессор представляет собой электронный прибор, предназначенный для формирования нормированного выходного сигнала для многоканального спектроанализатора (МСА). Размах этого выходного сигнала пропорционален амплитуде импульса на входе. Импульсный процессор располагается в тракте сигнала между выходом ФЭУ и входом МСА, в котором измеряют спектр ИМПУЛЬСОВ ЕДИЧНЫХ ФОТОНОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ, зарегистрированных УРИ; он может также использоваться для определения скорости счета с помощью контрольного детектора.

б) Для эффективного измерения сцинтиляций  $I$  (см. 5.4 настоящего стандарта), вызываемых амплитудным спектром ИМПУЛЬСОВ ЕДИЧНЫХ ФОТОНОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ, процессор может включать элементы, устраниющие искажающие сигналы, вызванные складыванием двух или более импульсов в течение измерения единичного импульса. Однако при рекомендуемых скоростях счета наличие фильтра «антисовпадений» обычно не требуется.

в) Для измерения КВАНТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ  $A_Q$  (см. 5.4 настоящего стандарта) нет оснований использовать фильтр «антисовпадений». Если он все же используется, он должен быть соединен с системой накопления эффективного времени измерения (эффективное время), которая разрешает накопление только в течение тех интервалов, когда процессор способен принимать сигналы. Если это условие не выполнено, ошибка измерений скорости счета превысит саму измеряемую величину.

#### 4.5.4 Многоканальный спектроанализатор (МСА)

а) Сигналы с выхода импульсного процессора должны быть зарегистрированы таким образом, чтобы определяемое число зарегистрированных событий было бы функцией амплитуды ИМПУЛЬСА ЕДИЧНЫХ ФОТОНОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ. МСА является общетехническим электронным прибором, способным реализовать эту задачу.

б) Канал, соответствующий нулевой амплитуде импульса, должен быть известен для точного расчета узловых точек спектра. Прецизионные генераторы импульсов способны обеспечить эту функцию.

в) Конструкцией МСА должен быть предусмотрен низкоуровневый дискриминатор (НД), который устраняет все импульсы ниже выбранного уровня.

г) Конструкция МСА должна обеспечивать возможность накопления «мертвого» времени, в течение которого МСА не способен подсчитывать входные импульсы.

д) Чтобы не насыщать МСА высокогенеративными квантами фонового шума, НД должен быть настроен на уровень суммарного «мертвого» времени, которое должно быть не более 5 % суммарного времени измерения.

## 5 Определение КВАНТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ

Типовой амплитудный спектр импульсов сцинтиляций для контрольного детектора и УРИ представлен в приложении В.

### 5.1 Подготовка

#### 5.1.1 Измерение мощности падающего гамма-излучения

а) ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ, включающий его ФИЛЬТР (если требуется), и ВХОДНАЯ АПЕРТУРА должны быть расположены в соответствии с 4.4.2, перечисление а) и рисунком 1.

б) ВХОДНАЯ АПЕРТУРА должна быть расположена между ИСТОЧНИКОМ ИЗЛУЧЕНИЯ и контрольным детектором.

в) Контрольный детектор должен быть расположен по отношению к ВХОДНОЙ АПЕРТУРЕ

таким образом, чтобы он определял мощность потока гамма-излучения в сечении ВХОДНОЙ АПЕРТУРЫ в соответствии с требованиями в 5.2.1.

5.1.2 Измерение амплитудного спектра импульсов сцинтиляций

- а) ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ, включающий его фильтр (если требуется), и ВХОДНАЯ АПЕРТУРА должны быть геометрически расположены в соответствии с 4.4.2, перечисление а) и рисунком 1.  
б) ВХОДНАЯ АПЕРТУРА должна быть расположена между ИСТОЧНИКОМ ИЗЛУЧЕНИЯ и УРИ.

с) ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ и ВХОДНАЯ АПЕРТУРА должны быть выровнены вдоль ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСИ.

г) ВХОДНАЯ АПЕРТУРА должна быть расположена как можно ближе к ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ.

д) ФЭУ должен быть ориентирован на детектирование с выхода УРИ. Выход ФЭУ должен быть соединен с импульсным процессором, а выход последнего подключен к МСА.

**5.2 Измерение**

**5.2.1 Мощность потока падающего гамма-излучения**

а) С ИСТОЧНИКОМ ИЗЛУЧЕНИЯ, облучающим контрольный детектор, определяют скорость счета  $R_c$  импульсов, включающую скорость счета импульсов источника  $R_u$  и фонового шума  $R_w$  в области энергий, достаточных для обеспечения требуемой точности измерений мощности падающего потока в соответствии с 5.2.1, перечисление д).

б) Сигнал от контрольного детектора, соответствующий поглощению при энергиях менее 10 кэВ, должен быть заблокирован соответствующей настройкой НД;

в) С удаленным ИСТОЧНИКОМ ИЗЛУЧЕНИЯ определяют скорость счета  $R_w$ , соответствующую фоновому шуму.

г) Скорость счета фонового шума  $R_w$  должна быть вычтена из полной скорости  $R_c$ .

д) Общее время счета  $\tau$  должно быть таким, чтобы число накопленных отсчетов  $(R_c - R_w) \cdot \tau$  было бы не менее 100000.

Примечание —  $\tau$  представляет собой эффективное время, другими словами, суммарное время измерений, меньшее «мертвого времени», в течение которого система не способна принимать и обрабатывать сигналы.

е) Разность  $R_c - R_w$  должна быть скорректирована с учетом КВАНТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ контрольного детектора для фотонов энергией 59,5 кэВ с тем, чтобы получить корректный результат для скорости счета источника  $R_u$ .

ж) Измерения  $R_u$  должны быть выполнены с пределами допускаемой погрешности  $\pm 1\%$ .

**5.2.2 Амплитудный спектр импульсов сцинтиляций**

а) Спектр ИМПУЛЬСОВ ЕДИНИЧНЫХ ФОТОНОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ определяется при облучении УРИ ИСТОЧНИКОМ ИЗЛУЧЕНИЯ.

б) Время  $\tau_x$ , в течение которого определяется спектр, должно быть достаточно большим, чтобы число достоверных отсчетов спектра (см. 5.2.2, перечисление д) было не менее 100000.

Примечание —  $\tau_x - \tau$  представляет собой эффективное время, другими словами общее время измерений, меньшее «мертвого времени», в течение которого система не способна принимать и обрабатывать сигналы.

в) Спектр сцинтиляций фонового шума определяется в течение этого же времени  $\tau_x$  при убранным ИСТОЧНИКЕ ИЗЛУЧЕНИЯ.

г) Спектр фонового шума должен быть вычен из спектра по 5.2.2, перечисление а), чтобы получить спектр отсчетов  $N_p$  для каждого уровня энергии  $E_j$  ИМПУЛЬСА ЕДИНИЧНОГО ФОТОНА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ.

д) Порог низких энергий должен быть определен как уровень энергии, при которой представленный спектр имеет минимум в интервале энергий от 0 до 25 кэВ (см. приложение В).

Для подсчета  $K_s$ , согласно настоящему стандарту, число импульсов низкой энергии должно быть не более 20 % числа импульсов с уровнем энергии, соответствующим полному поглощению фотонов энергией 59,5 кэВ, то есть фотопику.

**5.3 Коррекция**

Не используется.

**5.4 Определение**

а)  $K_s$  рассчитывают по формуле

$$K_s = A_Q I,$$

где  $I$  — эффективность сцинтиляций, которая определяется по формуле

$$I = (M_1)^2 / (M_2 M_0),$$

где  $M_i$  —  $i$ -й момент амплитудного спектра импульсов сцинтиляций, выраженный как

$$M_i = \sum_j N_f(E_j)^i,$$

где  $N_j$  — число импульсов со значением энергии  $E_j$ .

Минимальное значение  $E_j$  в этих расчетах должно соответствовать порогу низкой энергии по 5.2.2, перечисление е).

**КВАНТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ УРИ**  $A_Q$  определяется по формуле

$$A_Q = (M_0 / \tau_x) / R_w$$

где  $M_0$  — определяется таким же образом, как и в 5.4, перечисление а);

$\tau_x$  — время накопления, необходимое для получения спектра, как описано в 5.2.2, перечисление б);

$R_w$  — определено в 5.2.1.

**Примечание** — Формула для расчета  $K_s$  объясняется в [1], [2] и [3] приложения Г.

б) Определение должно иметь абсолютную погрешность в пределах  $\pm 2\%$ .

## 6 Представление КВАНТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ

Представление  $K_s$  должно содержать следующую информацию:

- идентификацию УРИ (общий тип, наименование или номер модели);
- значение  $K_s$ , %.

## 7 Обозначение соответствия

Если требуется подтвердить определение КВАНТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ в соответствии с настоящим стандартом, то оно должно быть указано:

- КВАНТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ по ГОСТ Р МЭК 61262.5—99.



Рисунок 1 — Схема расположения ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ и ВХОДНОЙ АПЕРТУРЫ

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(справочное)


**Указатель терминов**

В настоящем указателе для каждого термина указан соответствующий номер пункта раздела «Определения» настоящего стандарта (3.1) или обозначение термина по МЭК 60788 (МР-...-...).

<b>АКТИВНОСТЬ</b>	MP-13-18
<b>ВХОДНАЯ АПЕРТУРА</b>	3.1.13
<b>ВХОДНАЯ ПЛОСКОСТЬ</b>	3.1.2
<b>ВХОДНОЕ ПОЛЕ</b>	3.1.3
<b>ВХОДНОЙ ЭКРАН</b>	MP-32-47
<b>ВЫХОДНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ УРИ</b>	MP-32-49
<b>ВЫХОДНОЙ ЭКРАН УРИ</b>	MP-32-48
<b>ДЕТЕКТОР ИЗЛУЧЕНИЯ</b>	MP-51-01
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬР</b>	MP-35-02
<b>ИМПУЛЬС ЕДИНИЧНОГО ФОТОНА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ</b>	3.1.14
<b>ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ</b>	MP-20-01
<b>КВАНТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ (<math>A_q</math>)</b>	3.1.12
<b>КВАНТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ (<math>K_q</math>)</b>	3.1.11
<b>НОРМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ</b>	MP-82-04
<b>ОТСЕИВАЮЩИЙ РАСТР</b>	MP-32-06
<b>ПУЧОК ИЗЛУЧЕНИЯ</b>	MP-37-05
<b>РАССТОЯНИЕ ИСТОЧНИК — ВХОДНАЯ ПЛОСКОСТЬ (РИВ)</b>	3.1.5
<b>РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ</b>	MP-20-20
<b>РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ</b>	MP-32-01
<b>СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b>	MP-82-01
<b>ТЕСТ-ОБЪЕКТ</b>	MP-71-04
<b>УРИ</b>	3.1.1
<b>УСИЛИТЕЛЬ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (УРИ)</b>	MP-32-39
<b>ФИЛЬР</b>	MP-35-01
<b>ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОСЬ</b>	3.1.8
<b>ЦЕНТР ВХОДНОГО ПОЛЯ</b>	3.1.7
<b>ЦЕНТР ВЫХОДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ</b>	3.1.6
<b>ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ</b>	MP-32-40
<b>ЭФФЕКТИВНАЯ АПЕРТУРА</b>	3.1.10

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
(справочное)

Типовая схема проведения испытаний

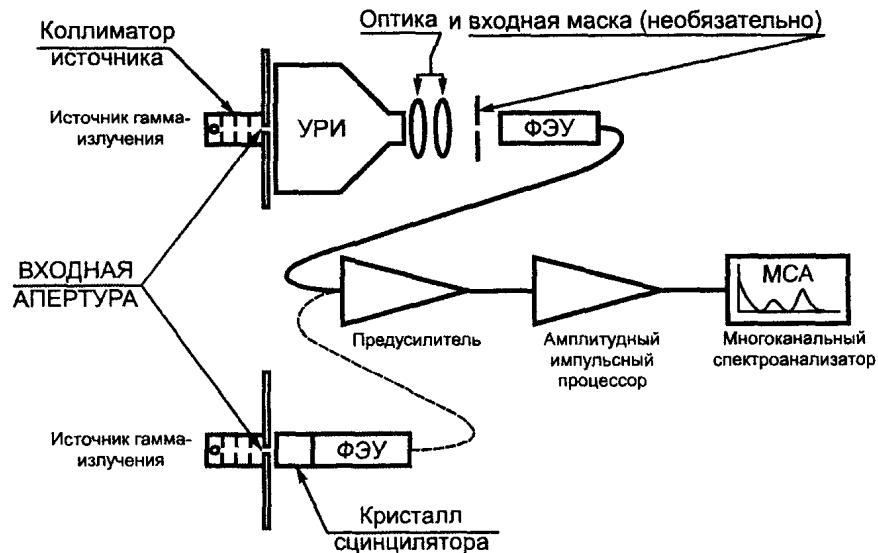

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
(справочное)

**Типовой амплитудный спектр импульсных сцинтиляций**

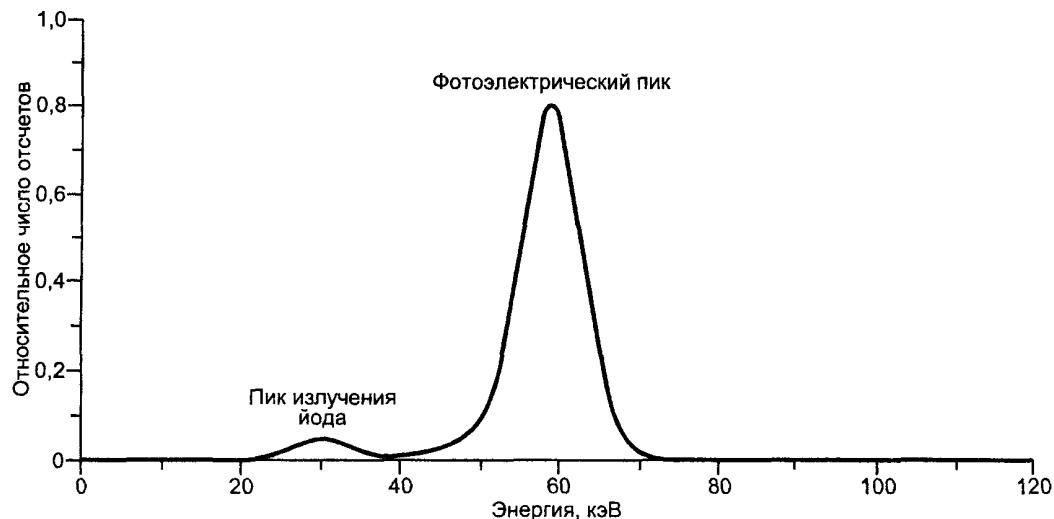


Рисунок С.1 — Контрольный детектор

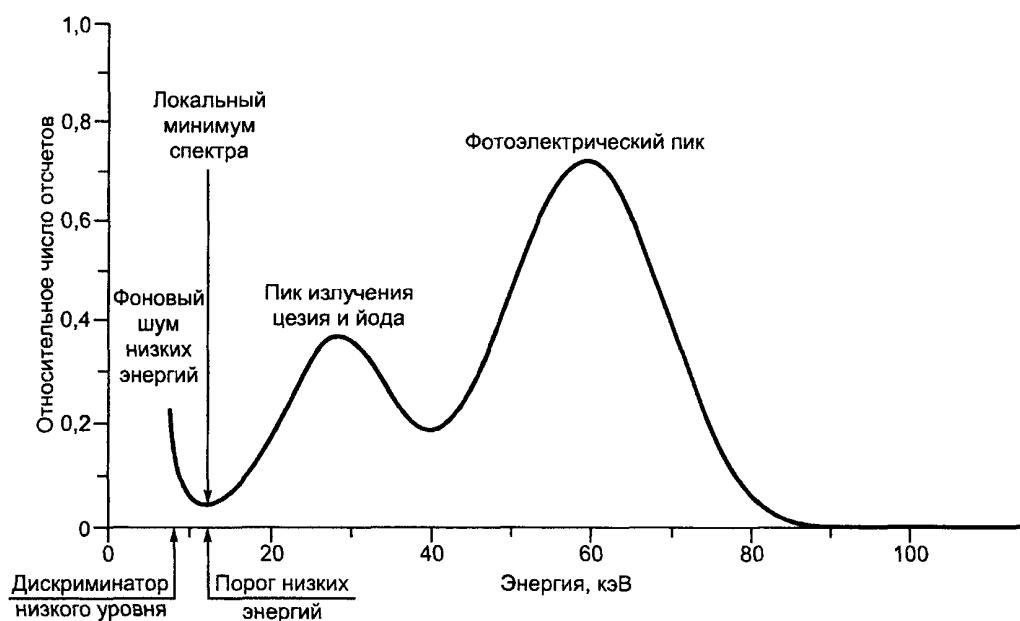


Рисунок С.2 — Электронно-оптический усилитель рентгеновского изображения

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
(справочное)

**Библиография**

- [1] *Journal of Applied Physics*, Vol. 44, Sep. 1973, R. K. Swank. «Absorption and noise in X-ray phosphors». pp. 4199—4203.
- [2] *Journal of Applied Physics*, Vol. 45, Aug. 1974, R. K. Swank, «Measurement of Absorption and Noise' in an X-ray Image Intensifier», pp. 3673—3678.
- [3] *Medical Physics*, Vol. 10, Nov./Dec. 1983, J. A. Rowlands and K. W. Taylor, «Absorption and Noise in Cesium Iodide X-ray Image Intensifiers», pp. 786—795.
- [4] *Medical Physics*, Vol. 11. Sep./Oct. 1984, J. A. Rowlands and K. W. Taylor, «Detective Quantum Efficiency of X-ray Image Intensifiers: Comparison of Scintillation Spectrum and rms Methods», pp. 597—601.
- [5] *Proceedings of SPIE*, Vol. 206, 27—29 Aug. 1979, H. Roehrig, B. Lum, D. Fisher, D. Ouimette, M. P. Capp, M. M. Frost, and S. Nudelman, «Digital method to evaluate the noise of X-ray image intensifiers», pp. 135—145.

УДК 615.84.001.4:006.354

ОКС 19.100

E84

ОКП 94 4220

Ключевые слова: изделия медицинские электрические, рентгеновское изображение, электронно-оптический усилитель, квантовая эффективность регистрации

---

Редактор *М.В. Глушкова*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *В.И. Вареникова*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 04.07.2000. Подписано в печать 14.09.2000. Усл.печ.л. 1,86. Уч.-изд.л. 1,25.  
Тираж 180 экз. С 5860. Зак. 807.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102